

# Systeme d'enregistreurs de donnees WiFi

testo Saveris 2 –  
La surveillance de la temperature,  
de l'humidite et du CO<sub>2</sub> repensee

---

Transmission des donnees via WiFi

---

Disponibilite de toutes les donnees de mesure partout et  
tout le temps, sur n'importe quel appareil

---

Alarme en cas de depassement de seuils

---

Hepbergement des donnees en ligne gratuit (Cloud Testo)

---



Le systeme d'enregistreurs de donnees WiFi testo Saveris 2 est la solution moderne pour la surveillance des valeurs de temperature et d'humidite ainsi que de la concentration en CO<sub>2</sub> dans les locaux de stockage et de travail. L'installation du systeme est tres facile et peut se faire via un navigateur ou a l'aide de l'App testo Saveris 2. Les enregistreurs de donnees WiFi enregistrent la temperature, l'humidite et la concentration en CO<sub>2</sub> de maniere fiable a des intervalles reglables et transmettent les valeurs de mesure directement


via un reseau WiFi vers le Cloud Testo.

Les valeurs de mesure enregistrees peuvent etre consultees partout et tout le temps grace a une tablette ou un PC connectes a Internet. Les depassements des limites sont tout de suite signales par e-mail, en option par SMS ou via l'App testo Saveris 2 sous forme de message Push. Ainsi, les processus critiques sont toujours maîtres même si l'on ne se trouve pas sur le site.

De plus, grace a la longue autonomie des piles, le systeme testo Saveris 2 n'a quasiment pas besoin d'entretien.

## La surveillance du climat repensée

Le système d'enregistreurs de données testo Saveris 2 vous permet de garder les conditions climatiques ambiantes sous contrôle très simplement – où que vous soyez.

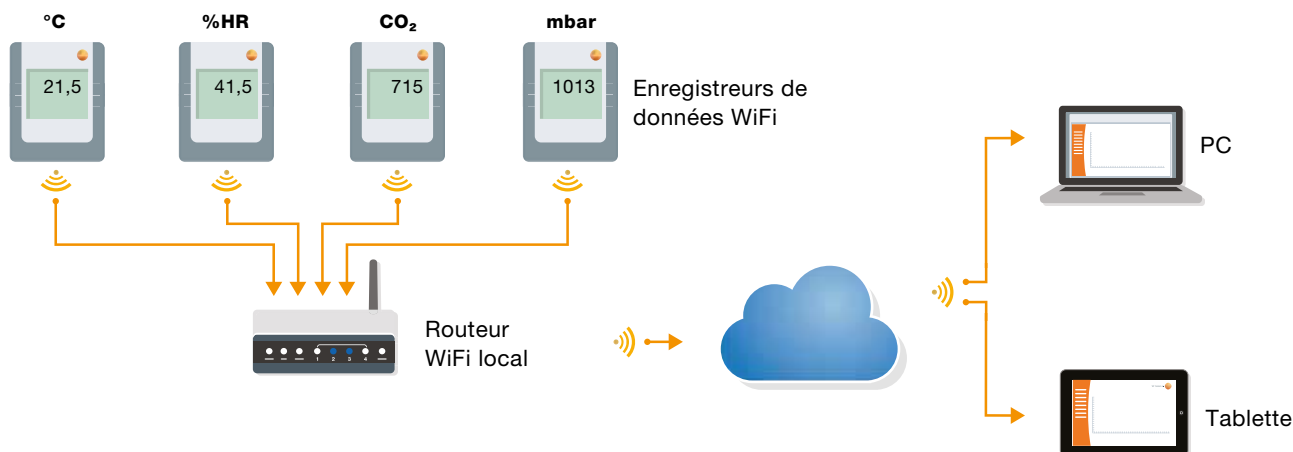

## Cloud testo Saveris 2

### Nos packs

Le Cloud testo est l'élément de commande central pour la configuration de votre système testo Saveris 2. Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, définir des limites d'alarme et évaluer vos données de mesure. Vous devez vous inscrire sur [www.saveris.net](http://www.saveris.net) pour accéder au Cloud testo. Lors de l'utilisation du Cloud testo, vous avez le choix entre les fonctions de base de la licence «Basic» gratuite ou celle de la licence «Avancée» qui offre des fonctionnalités plus complètes et adaptées à vos besoins. Les deux options vous offrent l'accès à une interface API pour exporter les données de mesure vers des systèmes supérieurs.

	Basic <b>Gratuit</b>	Advanced
<b>Cadence de mesure</b>	15 min. ... 24 h	1 min. ... 24 h
<b>Cadence de communication</b>	15 min. ... 24 h	1 min. ... 24 h
<b>Stockage des données</b>	max. 3 mois	max. 2 ans
<b>Rapports</b>	manuels (.pdf / .csv)	manuels (.pdf / .csv) automatiques (.pdf / .csv)
<b>Analyse des données</b>	respectivement pour un point de mesure (les sondes externes sont considérées comme point de mesure à part)	pour jusqu'à 10 canaux de mesure simultanément
<b>Nombre d'utilisateurs par compte</b>	1	10
<b>Nombre d'enregistreurs de données WiFi par compte</b>	illimitée	illimitée
<b>Options d'alarme</b>	Limites d'alarme supérieure/inférieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limites d'alarme supérieure/inférieure</li> <li>Temporisation de l'alarme</li> <li>Activation des alarmes en fonction de l'heure</li> </ul>
<b>Messages du système</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Message en cas de niveau de la pile faible</li> <li>Connexion WiFi interrompue</li> <li>Panne de courant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Message en cas de niveau de la pile faible</li> <li>Connexion WiFi interrompue</li> <li>Panne de courant</li> </ul>
<b>Alarmes par e-mail</b>	oui	oui
<b>Alarmes par SMS</b>	non	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 SMS par enregistreur et par an</li> <li>Option d'achat de packs de SMS supplémentaires</li> </ul>
	Licence pour 12 mois Réf. 0526 0735	Licence pour 24 mois Réf. 0526 0732
		Licence pour 36 mois Réf. 0526 0733

## Références – Enregistreurs de données WiFi

### testo Saveris 2-T1

testo Saveris 2-T1 ; enregistreur de données WiFi avec écran et capteur de température CTN interne, livré avec câble USB, support mural, piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 2031

### testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-H1 ; enregistreur de données WiFi avec écran et capteur de température/humidité interne, livré avec câble USB, support mural avec système de verrouillage, piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 2034

### testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-T2 ; enregistreur de données WiFi avec écran pour la mesure de la température, deux entrées de sondes de température CTN externes ou contacts de porte, livré avec câble USB, support mural, piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 2032

### testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-H2 ; enregistreur de données WiFi avec écran pour la mesure de la température et de l'humidité relative, entrée pour une sonde d'humidité externe, livré avec câble USB, support mural, piles



Réf. 0572 2035

### testo Saveris 2-T3

testo Saveris 2-T3 ; enregistreur de données WiFi avec écran pour la mesure de la température, deux entrées de sondes de température TC externes (types K, T, J), livré avec câble USB, support mural, piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 2033

### testo 160 IAQ

testo 160 IAQ, enregistreur de données IAQ WiFi pour la qualité de l'air avec écran et capteurs intégrés pour la température, l'humidité, le CO<sub>2</sub> et la pression atmosphérique, livré avec bloc secteur



Réf. 0572 2014

### testo Saveris 2 – kit pour surveiller la température dans un réfrigérateur ou en chambre froide

testo Saveris 2-T2 ; enregistreur de données WiFi avec écran pour la mesure de la température, deux entrées de sondes de température CTN externes ou contacts de porte, livré avec deux sondes de température cordon plat, deux flacons de simulation de température à remplir d'un tampon de température approprié pour l'application respective, câble USB, support mural, piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 2103

Veillez noter qu'un enregistreur de données WiFi, une inscription sur le Cloud testo ([www.saveris.net](http://www.saveris.net)), ainsi qu'un réseau compatible WiFi sont impérativement nécessaires pour l'utilisation du système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2.







# Données techniques

	testo Saveris 2-T1	testo Saveris 2-T2	testo Saveris 2-T3			testo Saveris 2-H1	testo Saveris 2-H2	testo 160 IAQ
<b>Mesure de température</b>								
Type de capteur	CTN interne	CTN	TC de type K	TC de type J	TC de type T	CTN interne	CTN	
Étendue de mesure	-30 ... +50 °C	-50 ... +150 °C	-195 ... +1350 °C	-100 ... +750 °C	-200 ... +400 °C	-30 ... +50 °C	Étendue de mesure et précision en fonction des sondes	0 ... +50 °C
Précision : ±1 digit	±0,5 °C	±0,3 °C	±(0,5 + 0,5 % v.m.) °C			±0,5 °C		±0,5 °C
Résolution	0,1 °C							0,1 °C
<b>Mesure d'humidité</b>								
Étendue de mesure	-					0 ... 100 %HR	Étendue de mesure et précision en fonction des sondes	0 ... 100 %HR
Précision	-					±2 %HR		±2 %HR à +25 °C et 20 ... 80 %HR ±3 %HR à +25 °C et <20 %HR et >80 %HR ±1 %HR hystérésis ±1 %HR de dérive par an
Résolution	-							0,1 %HR
<b>Mesure du CO<sub>2</sub></b>								
Étendue de mesure	-							0 ... 5 000 ppm
Précision	-							±(50 ppm + 3 % v.m.) à +25 °C Sans alimentation externe : ±(100 ppm + 3 % v.m.) à +25 °C
Résolution	-							1 ppm
<b>Mesure de pression</b>								
Étendue de mesure	-							600 ... 1100 mbars
Précision	-							±3 mbars à +22 °C
Résolution	-							1 mbar
<b>Mesure de la température / l'humidité au moyen de sondes externes</b>								
Raccord pour sonde externe	-	Sondes de température externes	Sondes de température externes			-	Sondes d'humidité / de température externes	-
<b>Données techniques générales</b>								
Température de service	-30 ... +50 °C							0 ... +50 °C
Température de stockage (sans piles)	-40 ... +70 °C							-20 ... +50 °C
Indice de protection	IP 65	IP 65	IP 54			IP 30	IP 54	IP 20
Cadence de mesure	dépend de la licence Cloud / Basic : 15 min ... 24 h / Avancée : 1 min ... 24 h testo 160 IAQ – Avancée fonctionnement sur batterie : 5 min ... 24 h							
Cadence de communication	dépend de la licence Cloud / Basic : 15 min ... 24 h / Avancée : 1 min ... 24 h							
Mémoire	10 000 valeurs de mesure / canal							32 000 valeurs de mesure (total de tous les canaux)
Normes / Homologations	EN 12830	EN 12830	-					
Autonomie des piles	12 mois (valeur typique, dépend de l'infrastructure WiFi) à +25 °C, 15 min de cadence de mesure cadence de communication standard à -30 °C, 15 min de cadence de mesure et cadence de communication standard avec piles Energizer 0515 0572							12 mois
Alimentation	4 x piles Mignon AA AIMn ; bloc d'alimentation en option ; pour les températures inférieures à -10 °C, utiliser des piles Energizer 0515 0572							4 piles alcalines manganèse AA 1,5 V, alternativement par bloc d'alimentation via connexion USB
Dimensions	95 x 75 x 30,5 mm					115 x 82 x 31 mm	95 x 75 x 30,5 mm	117 x 82 x 32 mm
Poids (piles installées)	240 g					250 g	240 g	269 g
Contact de porte	non	en option	non					
<b>Communication</b>								
WiFi	Transmission des signaux : sans fil ; bande des fréquences : 2,4 GHz ; standards WiFi supportés : IEEE 802.11 b/g/n et IEEE 802.1X Méthodes de cryptage possibles : sans cryptage, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise Les enregistreurs de données communiquent via le protocole standard MQTT et maîtrisent la synchronisation d'horloge SNTP.							

## Références - Accessoires







Accessoires	Réf.
Contact de porte pour enregistreur de données WiFi testo Saveris 2-T2	0572 2152
Bloc d'alimentation pour enregistreur de données WiFi testo Saveris 2	0572 2020
Piles pour sondes radio (4 piles alcalines manganèse AA)	0515 0414
Piles pour l'utilisation des enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 en dessous de -10 °C (4 x Energizer L91 Photo-Lithium)	0515 0572
Élément magnétique pour support mural testo Saveris 2 pour la fixation sur les surfaces magnétiques	0554 2001
Support mural pour testo 160 IAQ	0554 2015
Coque décorative pour testo 160 IAQ	0554 2012
Prestations peinture à partir de 20 couvercles. Colori en fonction de votre choix	200554 20SH
Certificat d'étalonnage ISO pour la température, sonde de température ; points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil	0520 0153
Certificat d'étalonnage DAkkS pour la température, sonde de température ; points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil	0520 0262
Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité ; points d'étalonnage : 11,3 %HR et 75,3 %HR à +25 °C/+77 °F ; par canal/appareil	0520 0076
Certificat d'étalonnage DAkkS pour l'humidité ; sonde d'humidité ; points d'étalonnage : 11,3 %HR et 75,3 %HR à +25 °C ; par canal/appareil	0520 0246
Certificat d'étalonnage ISO pour le CO2, points d'étalonnage : 0, 1 000, 5 000 ppm	0520 0033

## Sondes de température pour testo Saveris 2-T2

Type de sonde	Dimensions Sonde/Pointe sonde	Étendue de mesure	Précision	t <sub>99</sub>	Réf.
Sonde pour segment, IP 54	 35 mm Ø 3 mm	-20 ... +70 °C	±0,2 °C (-20 ... +40 °C) ±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)	15 sec	0628 7510
Sonde encastrée avec gaine en aluminium, IP 65, câble fixe étiré de 2,4 m	 40 mm Ø 6 mm	-30 ... +90 °C	±0,2 °C (0 ... +70 °C) ±0,5 °C (étendue restante)	190 sec	0628 7503
Sonde d'immersion / de pénétration précise, longueur du câble : 6 m, IP 67, câble fixe étiré	 40 mm Ø 3 mm	-35 ... +80 °C	±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (étendue restante)	5 sec	0610 1725
Sonde pour mesure de contact, câble fixe étiré de 2 m	 40 mm 8 x 8 mm	-50 ... +80 °C	±0,2 °C (0 ... +70 °C)	150 sec	0628 7516
Sonde de pénétration CTN avec cordon plat, longueur de câble : 2 m, IP 54, câble fixe étiré	 60 mm 30 mm Ø 5 mm Ø 3,6 mm	-40 ... +125 °C	±0,5 % v.m. (+100 ... +125 °C) ±0,2 °C (-25 ... +80 °C) ±0,4 °C (étendue restante)	8 sec	0572 1001
Sonde pour tuyau avec Velcro pour tuyaux d'un diamètre de max. 75 mm, Tmax. +75°C ; CTN ; câble fixe étiré	 300 mm	-50 ... +70 °C	±0,2 °C (-25 ... +70 °C) ±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)	60 sec	0613 4611
Sonde de température externe, 12 mm, enfichable, sans câble	 105 mm Ø 12 mm Ø 20 mm	-30 ... +50 °C	±0,2 °C (-30 ... +50 °C)		0572 2153



**Vous trouverez d'autres sondes sur [www.testo.com](http://www.testo.com) !**

## Sondes de température pour testo Saveris 2-T3

Type de sonde	Dimensions Sonde/Pointe sonde	Étendue de mesure	Précision	t <sub>99</sub>	Réf.
Sonde avec enveloppe en acier inoxydable ; TC de type K	 40 mm Ø 6 mm Raccord : câble fixe étiré de 1,9 m	-50 ... +205 °C	Classe 2*	20 sec	0628 7533
Sonde de pénétration TC avec câble plat ; type K ; longueur de câble : 2 m ; IP 54	 60 mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3,6 mm	-40 ... +220 °C	Classe 1 (-25 ... +200 °C) Classe 2 (<-25 °C et >+200 °C)	7 sec	0572 9001
Sonde magnétique ; adhérence d'env. 10 N ; avec aimants ; pour températures élevées ; pour mesures sur surfaces métalliques ; TC de type K	 75 mm Ø 21 mm Raccord : câble fixe étiré de 1,6 m	-50 ... +400 °C	Classe 2*		0602 4892
Sonde pour tuyau pour diamètres de tuyau de 5 à 65 mm ; avec tête de mesure amovible ; étendue de mesure à court terme jusqu'à +280 °C ; TC de type K	 Raccord : câble fixe étiré de 1,2 m	-60 ... +130 °C	Classe 2*	5 sec	0602 4592
Sonde pour tuyau avec Velcro ; pour les mesures de température sur des tuyaux d'un diamètre max. de 120 mm ; Tmax. +120 °C ; TC de type K	 395 mm 20 mm Raccord : câble fixe étiré de 1,5 m	-50 ... +120 °C	Classe 1*	90 sec	0628 0020
Pointe de mesure par immersion à masse faible ; flexible ; idéale pour les mesures dans les petits volumes tels que les boîtes de Pétri ou pour les mesures de contact (fixation, p.ex., au moyen d'un ruban adhésif) ; TC de type K ; 2 m ; conduite thermique avec isolation FEP ; résistant à des températures jusqu'à 200 °C ; conduite ovale de 2,2 mm x 1,4 mm	 Ø 0,25 mm 500 mm	-200 ... +1000 °C	Classe 1*	1 sec	0602 0493

\* Selon norme EN 60584-2, précision Classe 1 de -40...+1000 °C (type K), Classe 2 de -40...+1200 °C (type K), Classe 3 de -200...+40 °C (type K).

## Sondes d'humidité / de température pour testo Saveris 2-H2

Type de sonde	Dimensions Sonde/Pointe sonde	Étendue de mesure	Précision	Réf.
Sonde d'humidité / de température, 12 mm, câble fixe étiré, longueur de câble : 1,3 m		-30 ... +70 °C 0 ... 100 %HR	±0,3 °C ±2 %HR à +25 °C (2 ... 98 %HR) 0,03 %HR/K ±1 digit	0572 2155
Sonde d'humidité / de température externe, 12 mm, enfichable sans câble	 105 mm Ø 12 mm Ø 20 mm	-30 ... +50 °C 0 ... 100 %HR	±0,5 °C ±2 %HR Coefficient de température : ±0,03 %HR/K (k=1) Stabilité à long terme : ±1 %HR/an	0572 2154

**Vous trouverez d'autres sondes sur [www.testo.com](http://www.testo.com) !**

